



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 09 lipca 2014 r.

AG-ZP 3320/33/ /14

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamicznej. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:



KOMITET
UPOPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **zadaniu 4** strzykawkę wysokociśnieniową do PTCA z manometrem o skali do 26 atm z możliwością wykonania szybkiej deflacji jedną ręką przez operatora, pozostałe parametry bez zmian ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **zadaniu 29** wyłącznie sond mechanicznych o częstotliwości 40 MHz z pominięciem sond elektronicznych, lub na wydzielenie dwóch odrębnych pakietów w tym zakresie ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

www.
szpital.zam.pl

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w **Zadaniu 17** cewniki balonowe do doprężeń o długościach 8; 10; 12; 15; 18 mm?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w **zadaniu 19** balony tnące gdzie elementem nacinającym są dwa druty uczestniczące w procesie dylatacji – wbudowany drut 0,011”, zintegrowany zewnętrznie na balonie, stanowiący platformę tnącą i standardowy gulde wire 0,014” ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

REGON
006050134

KRS
0000021024

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w **pakiecie 35** cewnik przedłużający o długości użytkowej 150 cm i świetle wewnętrznym 0,056” (dla cewnika 6F)?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
AG-ZP 3320/33/14 – wyjaśnienia SIWZ – 1

6. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 A, B


Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

A/ w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku w wysokości 0,2% wartości sprzętu brutto będącego przedmiotem Banku za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto sprzętu będącego przedmiotem banku

B/ w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu zamówienia albo poszczególnych jego części, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy.


Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

7. Dot. **Zadania nr 5**. Prosimy o dopuszczenie zamieszczonego na poniższej ilustracji Y-conectora o ergonomicznym kształcie typu push – click z drenem.

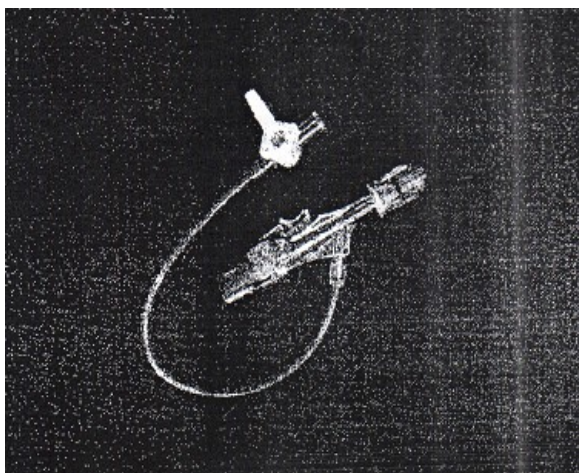

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

8. Dot. **Zadania nr 5**. Prosimy o dopuszczenie zamieszczonego na poniższej ilustracji Y-conectora o ergonomicznym kształcie typu push – click z drenem.

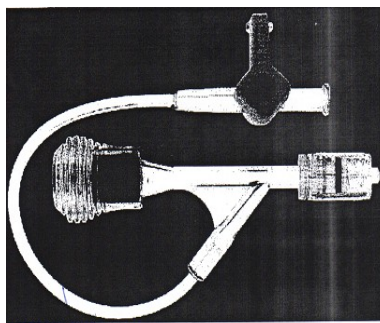

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Zadaniu nr 7** stentu o budowie zamkniętokomórkowej; o ciśnieniu RBP 18 atm dla wszystkich rozmiarów; o możliwości doprężenia średnic 2.25-2.75 do 2.62-3.19mm, 3.5-4.5 do 3.43-5.11mm; dostępne średnice 2.25, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 mm; pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Zadaniu nr 8** stentu o średnicach: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5mm z możliwością przepiężenia o 14%, średnicę 4.5mm można doprężyć do 5.11mm; pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Zadaniu nr 13** stentu o budowie zamkniętokomórkowej z systemem uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia (lek nie jest uwalniany do krwi); lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia; o ciśnieniu RBP 18 atm dla wszystkich średnic; o dostępnych długościach: 8, 12, 16, 20, 25, 31, 38 mm; z możliwością doprężenia średnic 2.25-2.75 do 2.62-3.19mm, 3.5-4.5 do 3.43-5.11mm; pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Zadaniu nr 28** cewnika balonowego o ciśnieniu nominalnym 6 atm; pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Zadaniu 30** introducera bez pokrycia hydrofilnego; o dostępnych długościach 7 i 11 cm oraz długości igły 4cm; pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Zadaniu 32** mikrocewnika o dostępnych długościach 135 i 150cm oraz profilu przejścia 2.8F (0,93mm); pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

15. **Pakiet nr 1.** Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki prowadzące w rozmiarze 5 – 8F o dużej średnicy wewnętrznej min. 0,082” przy 7F i 0,091” przy 8F, atraumatyczna

końcówka, dobrze widoczna w skopi, odporny na załamania i zagięcia, zachowujący światło na całej długości łącznie z końcówką, charakteryzujący się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu, pokryty hydrofilnie od zewnątrz, zbrojony metalowym opłotem, pełna gama kształtów i krzywizn (65 jeżeli patrzeć na dostępność każdej we wszystkich rozmiarach), bez następujących kształtów: RBU, JCL, 3D RIGHT, IMAK, RDCN, RDCK, o długościach cewników:

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

16. **Pakiet nr 25.** Czy zamawiający dopuści do oceny cewnik do trombectomii wieńcowej w rozmiarze 5 i 6 F, bez rozmiaru 7F, wyposażony w centralny otwór, średnica aspiracyjna wewn. 0,040". W zestawie – cewnik do odsysania, strzykawka o objętości 30cc, kranik i koszyk na skrzeplinę ?

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

17. Czy dla Pakietów 21, 25 i 30 Zamawiający wyrazi zgodę od odstąpienia od wymogu utworzenia „Banku” w zamian za termin dostawy dwa dni robocze?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy umowy integralnej części SIWZ.

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4 ust. 7 na następujący: „Sprzedający będzie rozpatrywał reklamacje ilościowe i jakościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji (...)”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy umowy integralnej części SIWZ.

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 na następujący: „Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przenieść na nią swych wierzytelności wynikających z umowy z wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy umowy integralnej części SIWZ.

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §9 na następujący: „W razie trzykrotnej zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu” [...]”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy umowy integralnej części SIWZ.

21. Dot. **Pakietu 30:** Czy zamawiający dopuści w zad. 30 zestaw wprowadzający do tętnicy promieniowej w rozmiarach 5Fr, 6Fr długość 11 i 24 cm. W zestawie koszulka hydrofilna z portem bocznym i zastawką hemostatyczną, dilatator, igła prosta 21G/2,54

cm, prowadnik prosty 0,018” (cala). Koszulka atraumatyczna, odporna na załamania i zagięcia.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek